



10 de Junho de 2020

Memorando GEC n° 1239/2020

A/C SHEYLA ARÁUJO

### AQUISIÇÃO CAMAS PARA UTI – CHAMAMENTO UNIFESP – COVID 19

Em análise ao solicitado informamos:

**MEDI SAÚDE:** Não atende ao solicitado:

- Rodízios: ofertou 4 polegadas, solicitado 6 polegadas
- Bateria: Modelo ofertado não possui bateria conforme solicitado em edital
- Carga Máxima: 250 kg, edital solicita 300 Kg.
- Não evidenciado o modelo MS 11.002 no site da ANVISA (anexo).

**CIRÚRGICA SÃO FELIPE:** Não apresentou catálogo do produto, copiou o descritivo na íntegra, portanto não permite avaliação. Pag. 8/9 da proposta.

**HILLROM:** Não atente ao edital

- Rodízios 5 polegadas, edital solicita 6 polegadas
- Carga Máxima: 204 kg, edital solicita 300 Kg.

**LINET BRASIL:** Não atende ao solicitado

- Carga Máxima: 250 kg, edital solicita 300 Kg.

#### Considerações finais:

Alteração do descritivo para ampliar participação, e consultar novamente as empresas referenciadas no quadro abaixo, e solicitar nova proposta de acordo com o descritivo a seguir.

FORNECEDORES	MODELO SUGERIDO	CONTATO
STRYKER	SV2	ANDERSON PETIZME 011 5189 2500 OU 99815 2782
HILL ROM	ACELLA 900	ROBSON HENRIQUE 011 970737999
LINET BRASIL	ELEGANZA 2	COMERCIAL 011 2786 1378
MEDSAÚDE	NÃO FOI POSSIVEL EVIDENCIAR	062 3278 0223 MURILO CARDOSO

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM ALTERAÇÕES PARA AMPLIAR SUCESSO NO CERTAME


CAMA HOSPITALAR - Especificação técnica mínima: • Cama Hospitalar elétrica com colchão • Material aço inoxidável, acabamento da superfície em pintura epóxi • Estrutura: em aço pintado • Base: em tubo de aço compatível com a aplicação, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. • Estrado articulado em chapa de Aço Carbono. • Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito, Trendelburg e Proclive acionados por quatro atuadores lineares com caixa de comando blindada com grau de proteção IPX4 ou superior. • Acionamento: através de controle remoto a fio, • Alimentação: 220v - 60hz.

• Grades: Dois pares de grades laterais sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente em material termoplástico. • Rodízios: 5" ou 6" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. • Para-choque de PVC ou borracha redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede • Capacidade segura: 250 KG ou superior • Dimensões externas aproximadas grades recolhidas: 2,00m x 0,95m X 0,80m (C x L x A) • Acabamento: pintura todas as peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, a base de fosfato de zinco, e acabamento em pintura eletrostática a pó em resina epóxi-poliéster, polimerizado, de excelente resistência química e mecânica. • Medidor de Angulação • Acionamento dos movimentos no caso de falta de energia, bateria com autonomia ciclos completos (elevação e descida com carga).

Acessórios de fornecimento Obrigatório:

• Suporte de soro em inox com dois ganchos adaptável aos quatro cantos da cama • Colchão compatível com o leito densidade D33, confeccionado em espuma de poliuretano em uma só peça, revestido em couvin resistente, lavável sem costura nas quinas laterais, capa soldada eletronicamente, com proteção antiácido, antialérgico elantibacteriano devendo permitir higienização diária.

Atenciosamente



Teogó Amaro Oliveira  
Coordenador de Incorporação de  
Equipamentos Médico Assistenciais



Engº Victor Piovezan  
Gerente de Engenharia Clínica

10/06/2020

## Aquisição de camas

3 mensagens

**SHEYLA DE SANTANA ARAUJO** <sheyla.araujo@unifesp.br>

28 de julho de 2020 19:06

Para: vania.simo.es@unifesp.br, oliveira.amaro@huhsp.org.br, piovezan@huhsp.org.br, jsilva@huhsp.org.br, meireles@unifesp.br, paulo.cammarata@huhsp.org.br

Vânia boa noite.

Este documento já continha os motivos de desclassificação. Ele não é suficiente?

Att

 **Memo GEC 1239-20 - Aquisição de Camas para UTI .pdf**  
588K

**Amaro Oliveira** <oliveira.amaro@huhsp.org.br>

28 de julho de 2020 19:09

Para: SHEYLA DE SANTANA ARAUJO <sheyla.araujo@unifesp.br>

Cc: VANIA SIMOES LOPES <vania.simo.es@unifesp.br>, Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>, jsilva@huhsp.org.br, meireles@unifesp.br, paulo.cammarata@huhsp.org.br

Boa noite Sheyla, esse mesmo!!!!

Obrigado

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**VANIA SIMOES LOPES** <vania.simo.es@unifesp.br>

29 de julho de 2020 08:22


Para: Amaro Oliveira <oliveira.amaro@huhsp.org.br>

Cc: SHEYLA DE SANTANA ARAUJO <sheyla.araujo@unifesp.br>, Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>, jsilva HSP <jsilva@huhsp.org.br>, meireles@unifesp.br, Paulo Cammarata <paulo.cammarata@huhsp.org.br>

Bom dia!

Sim, é suficiente. Ocorre que no processo tem apenas esse email. Vou juntar este outro documento enviado.

Att,

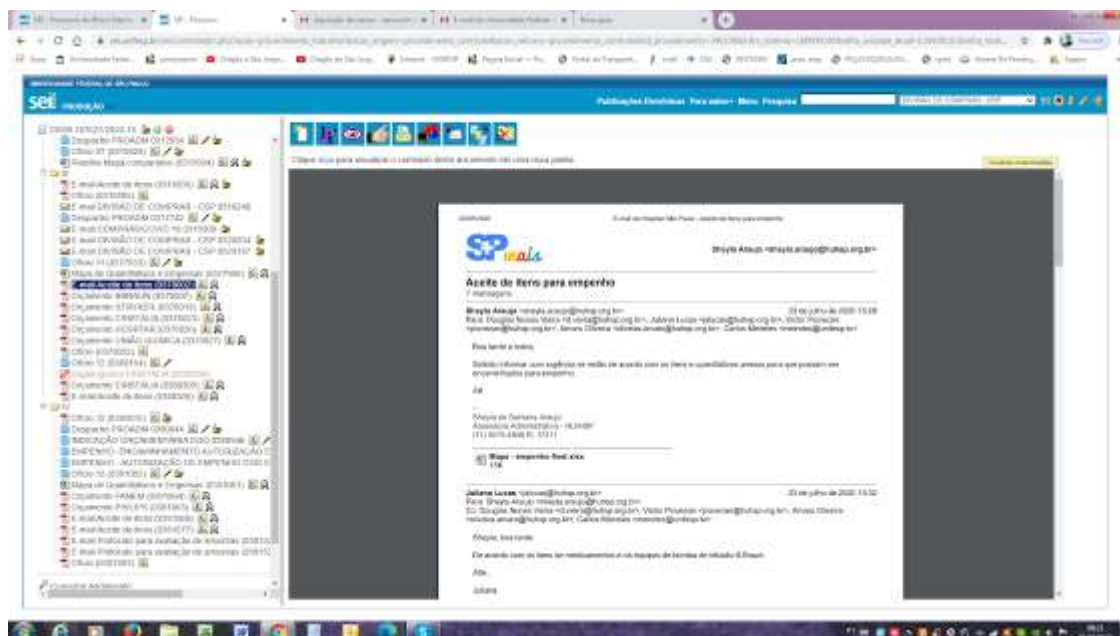

29/07/2020

E-mail de Universidade Federal de Sao Paulo - Aquisição de camas

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Vânia Simões Lopes Fioravanti**  
**Divisão de Compras- Campus São Paulo**  
**Universidade Federal de São Paulo**  
**Rua Botucatu, nº 740, 5º andar, São Paulo- SP**